


Plaatsen van een draadloze pacemaker

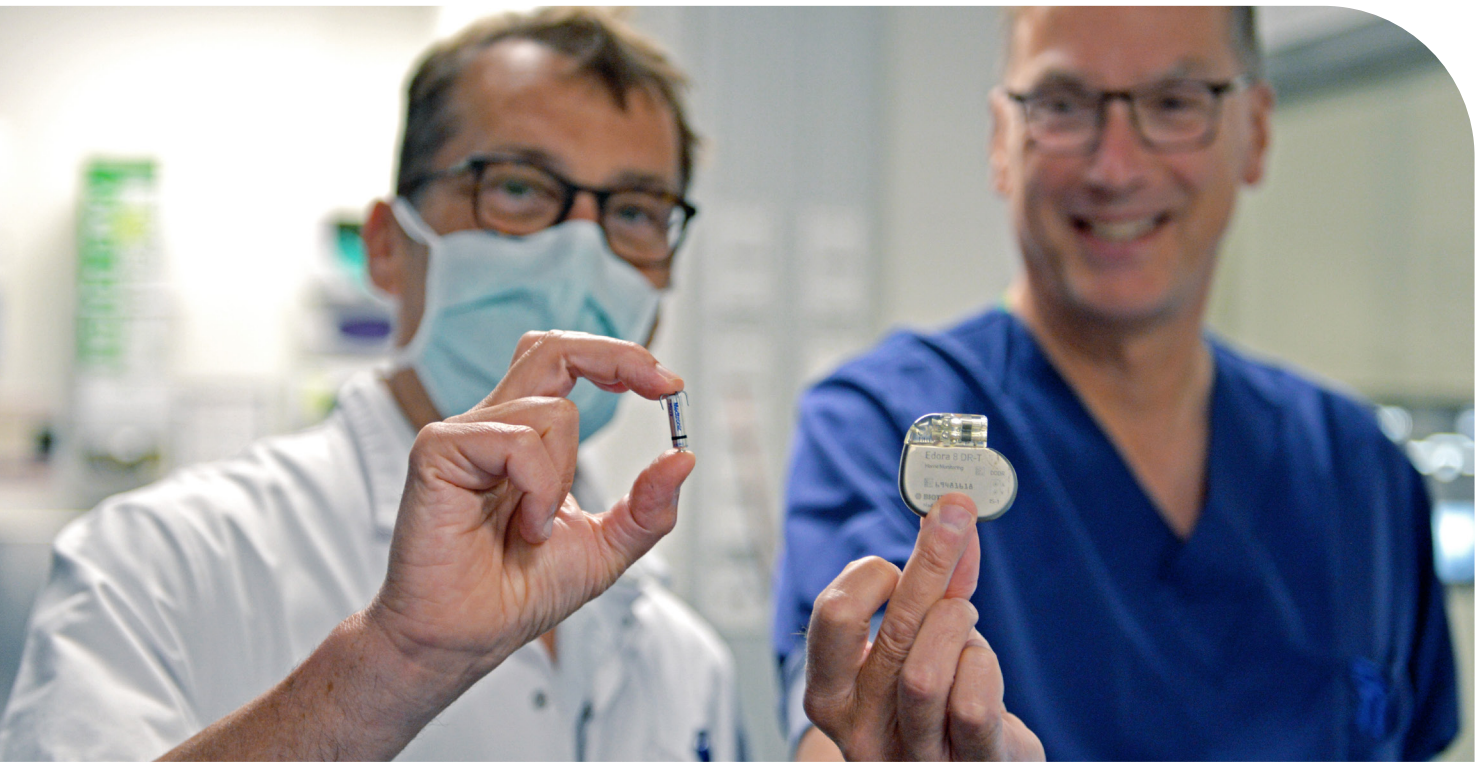

INHOUD

1	Klassieke of draadloze pacemaker?	4
2	Plaatsing van een draadloze pacemaker	5
	2.1 Voor de ingreep	5
	2.2 De ingreep	7
	2.3 Na de ingreep	8
	2.4 Mogelijke complicaties	8
3	Opgvolging thuis	8
4	Leven met een pacemaker	9
	Contactgegevens	11

Beste patiënt

Jij hebt in overleg met je behandelend arts beslist om een draadloze pacemaker te laten plaatsen. In deze brochure bundelen we nog eens alle informatie over de ingreep en het verloop van je ziekenhuisopname.

Deze brochure vervangt de persoonlijke gesprekken met arts en verpleegkundigen zeker niet. Aarzel niet hen te contacteren bij mogelijke vragen of problemen. Ze zullen je graag verder helpen.

Het cardiologisch team



1 Klassieke of draadloze pacemaker?

Een pacemaker is bedoeld om de natuurlijke hartslag na te bootsen als er sprake is van ritmestoornissen zoals pauzes in het natuurlijke hartritme of een te traag hartritme.

Een pacemaker heeft twee functies:

- **stimuleren** = elektrische impulsen geven
- **waarnemen** = kijken of er elektrische impulsen gegeven moeten worden

Bij een klassieke pacemaker moeten steeds één of meerdere draden in het hart geplaatst worden én is er een chirurgische insnede nodig.

Een draadloze pacemaker kan beide functies doen zonder draden in het hart en zonder chirurgische insnede.



Een draadloze pacemaker kan niet bij elke patiënt geplaatst worden. Je behandelend arts zal bepalen voor welke pacemaker jij in aanmerking komt.

2 Plaatsing van een draadloze pacemaker

2.1 Voor de ingreep

Voor het plaatsen van een draadloze pacemaker zal je twee dagen in het ziekenhuis opgenomen worden. Om je gezondheidstoestand voor de ingreep goed te kunnen evalueren zijn vaak extra onderzoeken nodig (bloedafname, electrocardiogram ...). Onze dienst vooropname zal je hierin begeleiden en je opnamedossier vervolledigen zodat de juiste resultaten tijdig bij de artsen terechtkomen.

Kom op de dag van je opname op het afgesproken uur naar ons ziekenhuis en meld je met je identiteitskaart aan via één van de e-kiosken in het atrium (inkomhal). Je krijgt via de e-kiosk een ticket met een volgnummer dat wordt geprojecteerd op de tv-schermen in het wachtpunt atrium. Je dossier wordt vervolledigd en je krijgt een zorgbandje met je naam, voornaam en geboortedatum. Daarna zal je opname via het cardiologisch dagziekenhuis verlopen.

ETEN EN DRINKEN VOOR JE INGREEP

Omdat je verdoofd zal worden voor de ingreep, is het noodzakelijk dat je de richtlijnen rond het nuchter zijn respecteert. Lees op mariamiddelares.be wat je tot welk moment mag eten en drinken (kijk bij 'anesthesie/anesthesie tijdens je opname'). Je vindt er ook meer info over de inname van thuismedicatie en enkele andere belangrijke aandachtspunten.





Als je antistollingsmedicatie neemt (Sintrom®, Marevan® (Acenocoumarol), Marcoumar®, Pradaxa®, Xarelto®, Lixiana® of Eliquis®) is het belangrijk dat te melden aan de verpleegkundige bij opname op het cardiologisch dagziekenhuis. Breng ook een lijstje mee met al je thuismedicatie.



Bij de onthaalbrochure of op mariamiddelares.be vind je een medicatiefiche.

Voor de start van de ingreep zal de verpleegkundige een infuus plaatsen en je een dosis antibiotica toedienen.




Ben je allergisch voor bepaalde antibiotica, meld dat bij opname zeker aan de verpleegkundige.

2.2 De ingreep

Het plaatsen van de pacemaker gebeurt onder volledige verdoving. Je wordt met je bed de hartkatheterisatiezaal binnengereden. De

verpleegkundige zal je vragen op de behandeltafel plaats te nemen. Er worden verschillende kleefelektroden aangebracht om je hartritme goed te kunnen volgen. Je rechterlies wordt geschoren en ontsmet en je wordt met steriele doeken afgedekt.

De arts zal de lies plaatselijk verdoven en in de ader van de (rechter)lies, een buisje inbrengen. Met behulp van een stuurbaar kathetersysteem wordt de draadloze pacemaker in de rechterkamer (rechtventrikel) van je hart ingebracht. De draadloze pacemaker wordt tegen de hartwand geplaatst en met flexibele weerhaakjes aan de hartwand vastgezet.

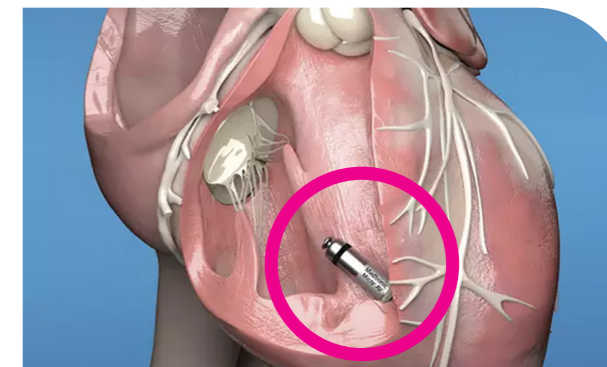

2.3 Na de ingreep

Na het plaatsen van de pacemaker, krijg je een kamer toegewezen met telemetrie. Zo kunnen we je hartritme na de ingreep nog even opvolgen.

2.4 Mogelijke complicaties

Elke ingreep kan complicaties meebrengen, ook al is er bij dit type pacemaker minder kans op problemen dan bij een conventionele pacemaker met draden.

Zeldzame verwikkelingen zijn:

- bloeditstorting in de aanprikplaats in de lies
- uitstorting van het vocht in het hartzakje (Pericardvocht) of teveel vocht in het hartzakje (tamponnade)
- verplaatsing van de pacemaker
- afsluiten van een bloedvat (embolisatie) door de pacemaker

3 Opvolging thuis

De arts vertelt je wanneer je terug naar huis kan. Bij ontslag krijg je een controleafspraak mee voor verdere opvolging na één maand. Nadien is er om de zes maanden een controle van de pacemaker nodig.

Als dat nodig is, kan er met behulp van een kleine monitor Informatie van je pacemaker naar het ziekenhuis gestuurd worden. Je arts kan zo je gegevens in het ziekenhuis bekijken via een beveiligde website. Het toestel is voorzien van een ingebouwde beveiliging die je implantaat en je gegevens beschermen. Zo hebben externe partijen geen toegang tot je implantaat ('hacken'). Ook alle gegevens die naar het ziekenhuis worden verzonden, zijn versleuteld.

“ Monitoring op afstand biedt eenvoudig toegang tot informatie die je arts in staat stelt om je hartaandoening te behandelen, je draadloze pacemaker te controleren en informatie van je draadloze pacemaker te verkrijgen wanneer dat nodig is.

4 Leven met een pacemaker

Omgevingsinvloeden

De meest gebruikte toestellen hebben geen invloed (interferentie) op je pacemaker.

- Afstandsbedieningen voor tv, garagepoort, stereo, camera ...
- Microgolfoven, fornuis, oven, mixer, stofzuiger, wasmachine, droogkast ...
- Elektrische dekens, haardrogers, zonnebanken ...
- Computers, radio's ...

Sommige toestellen hebben wel invloed op je pacemaker en mogen bijgevolg **NIET gebruikt** worden:

- Draaiende (auto)motoren en wisselstroomdynamo's
- Meetapparatuur voor vetpercentage (handbediend)
- Magnetische matrassen en stoelen
- Pneumatische boorhamers

Gebruik je een **elektrische (of hybride) wagen** als bestuurder of passagier, dan zijn er met een pacemaker geen restricties. Bij het laden van je elektrisch voertuig moet je wel wat voorzichtig zijn: er wordt aangeraden om een afstand van min. 60 cm te respecteren tussen je pacemaker en de oplader. Ook plaatsnemen in de wagen tijdens het opladen wordt afgeraden. Verder advies kan je steeds inwinnen bij de fabrikant van je wagen.

Antidiefstalsystemen

Wandel op normaal tempo door de antidiefstalsystemen aan in- en uitgangen van winkels.

Luchthavenbeveiliging

Je pacemaker bevat onderdelen die het metaal-detectoralarm in werking kunnen stellen. Laat beveiligingspersoneel je pacemakerkaart zien.

Medische behandelingen

- Meld bij elk doktersbezoek steeds dat je een draadloze pacemaker hebt.
- De draadloze pacemaker is goedgekeurd voor gebruik in een MRI-omgeving (bij magnetische resonantie). Door het unieke ontwerp kun je veilig een MRI-scan ondergaan als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Meld bij een bezoek aan een dienst radiologie steeds op voorhand dat je een draadloze pacemaker hebt.

NOTITIES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Contact gegevens

Heb je nog bezorgdheden of nood aan ondersteuning, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Secretariaat cardiologie

09 246 86 00

Check mariamiddelares.be voor meer info over onze dienst cardiologie.





Deze brochure is gedrukt op maxioffset.
Papier afkomstig uit bossen die duurzaam
worden beheerd.

VOLG ONS OOK OP:



[mariamiddelares.be](https://www.mariamiddelares.be)



Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent | 09 246 46 46 | info@mijnziekenhuis.be



Schutterijstraat 34, 9800 Deinze | 09 387 71 11 | info.deinze@mijnziekenhuis.be

AZ Maria Middelaes en AZ Sint-Vincentius Deinze hebben deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt.
Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden
bevatten, dan zijn AZ Maria Middelaes, AZ Sint-Vincentius Deinze, hun medewerkers en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

SAP 25678 - mei 2024